ステソクリーン（聴診器カバー）
取扱説明書

ステソクリーン（聴診器カバー）は、聴診器のチェストピースを覆い、聴診器を介しての患者間の感染を防ぎます。
ステソクリーン（聴診器カバー）はシングルペーシェントユースですので、一患者ごとに廃棄してください。

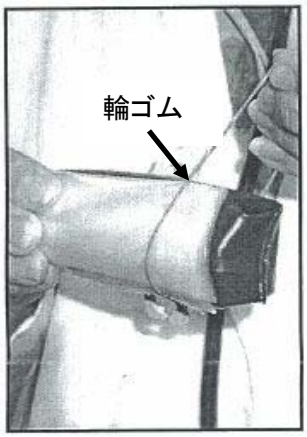

1. 輪ゴムを取り外します。

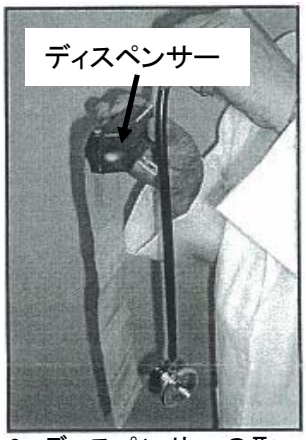

2. ディスペンサーの取付位置を決めます。

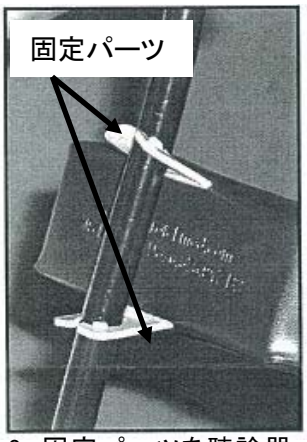

3. 固定パーツを聴診器のYチューブに挟みます。

4. **最初のカバーがディスペンサーから出る状態まで引き出し、**赤色斜線部分を切り離します。

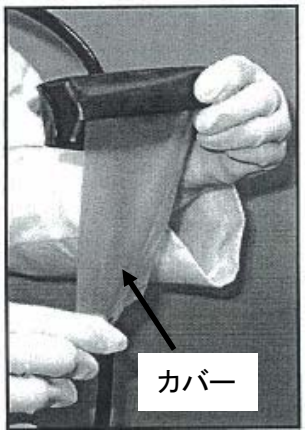

5. 次の赤色斜線部分が見えるまでカバーを引き出します。

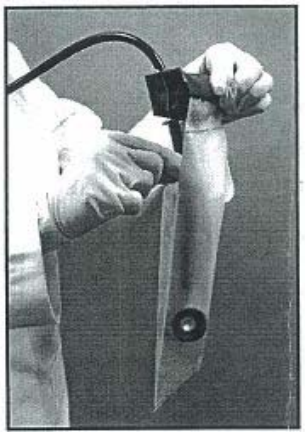
6. チェストピースを、カバーの切り込みから中へ入れます。

7. 準備ができました。

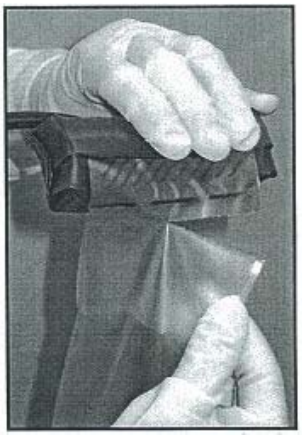
8. 赤色斜線部分の下にあるミシン目で切り離してご使用ください。

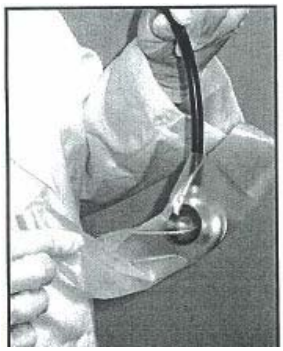
9. 使用後は廃棄してください。

次の患者に使用する場合は、4から9の手順を繰り返してください。

材質:ポリエチレン
ラテックスフリー

村中医療器株式会社